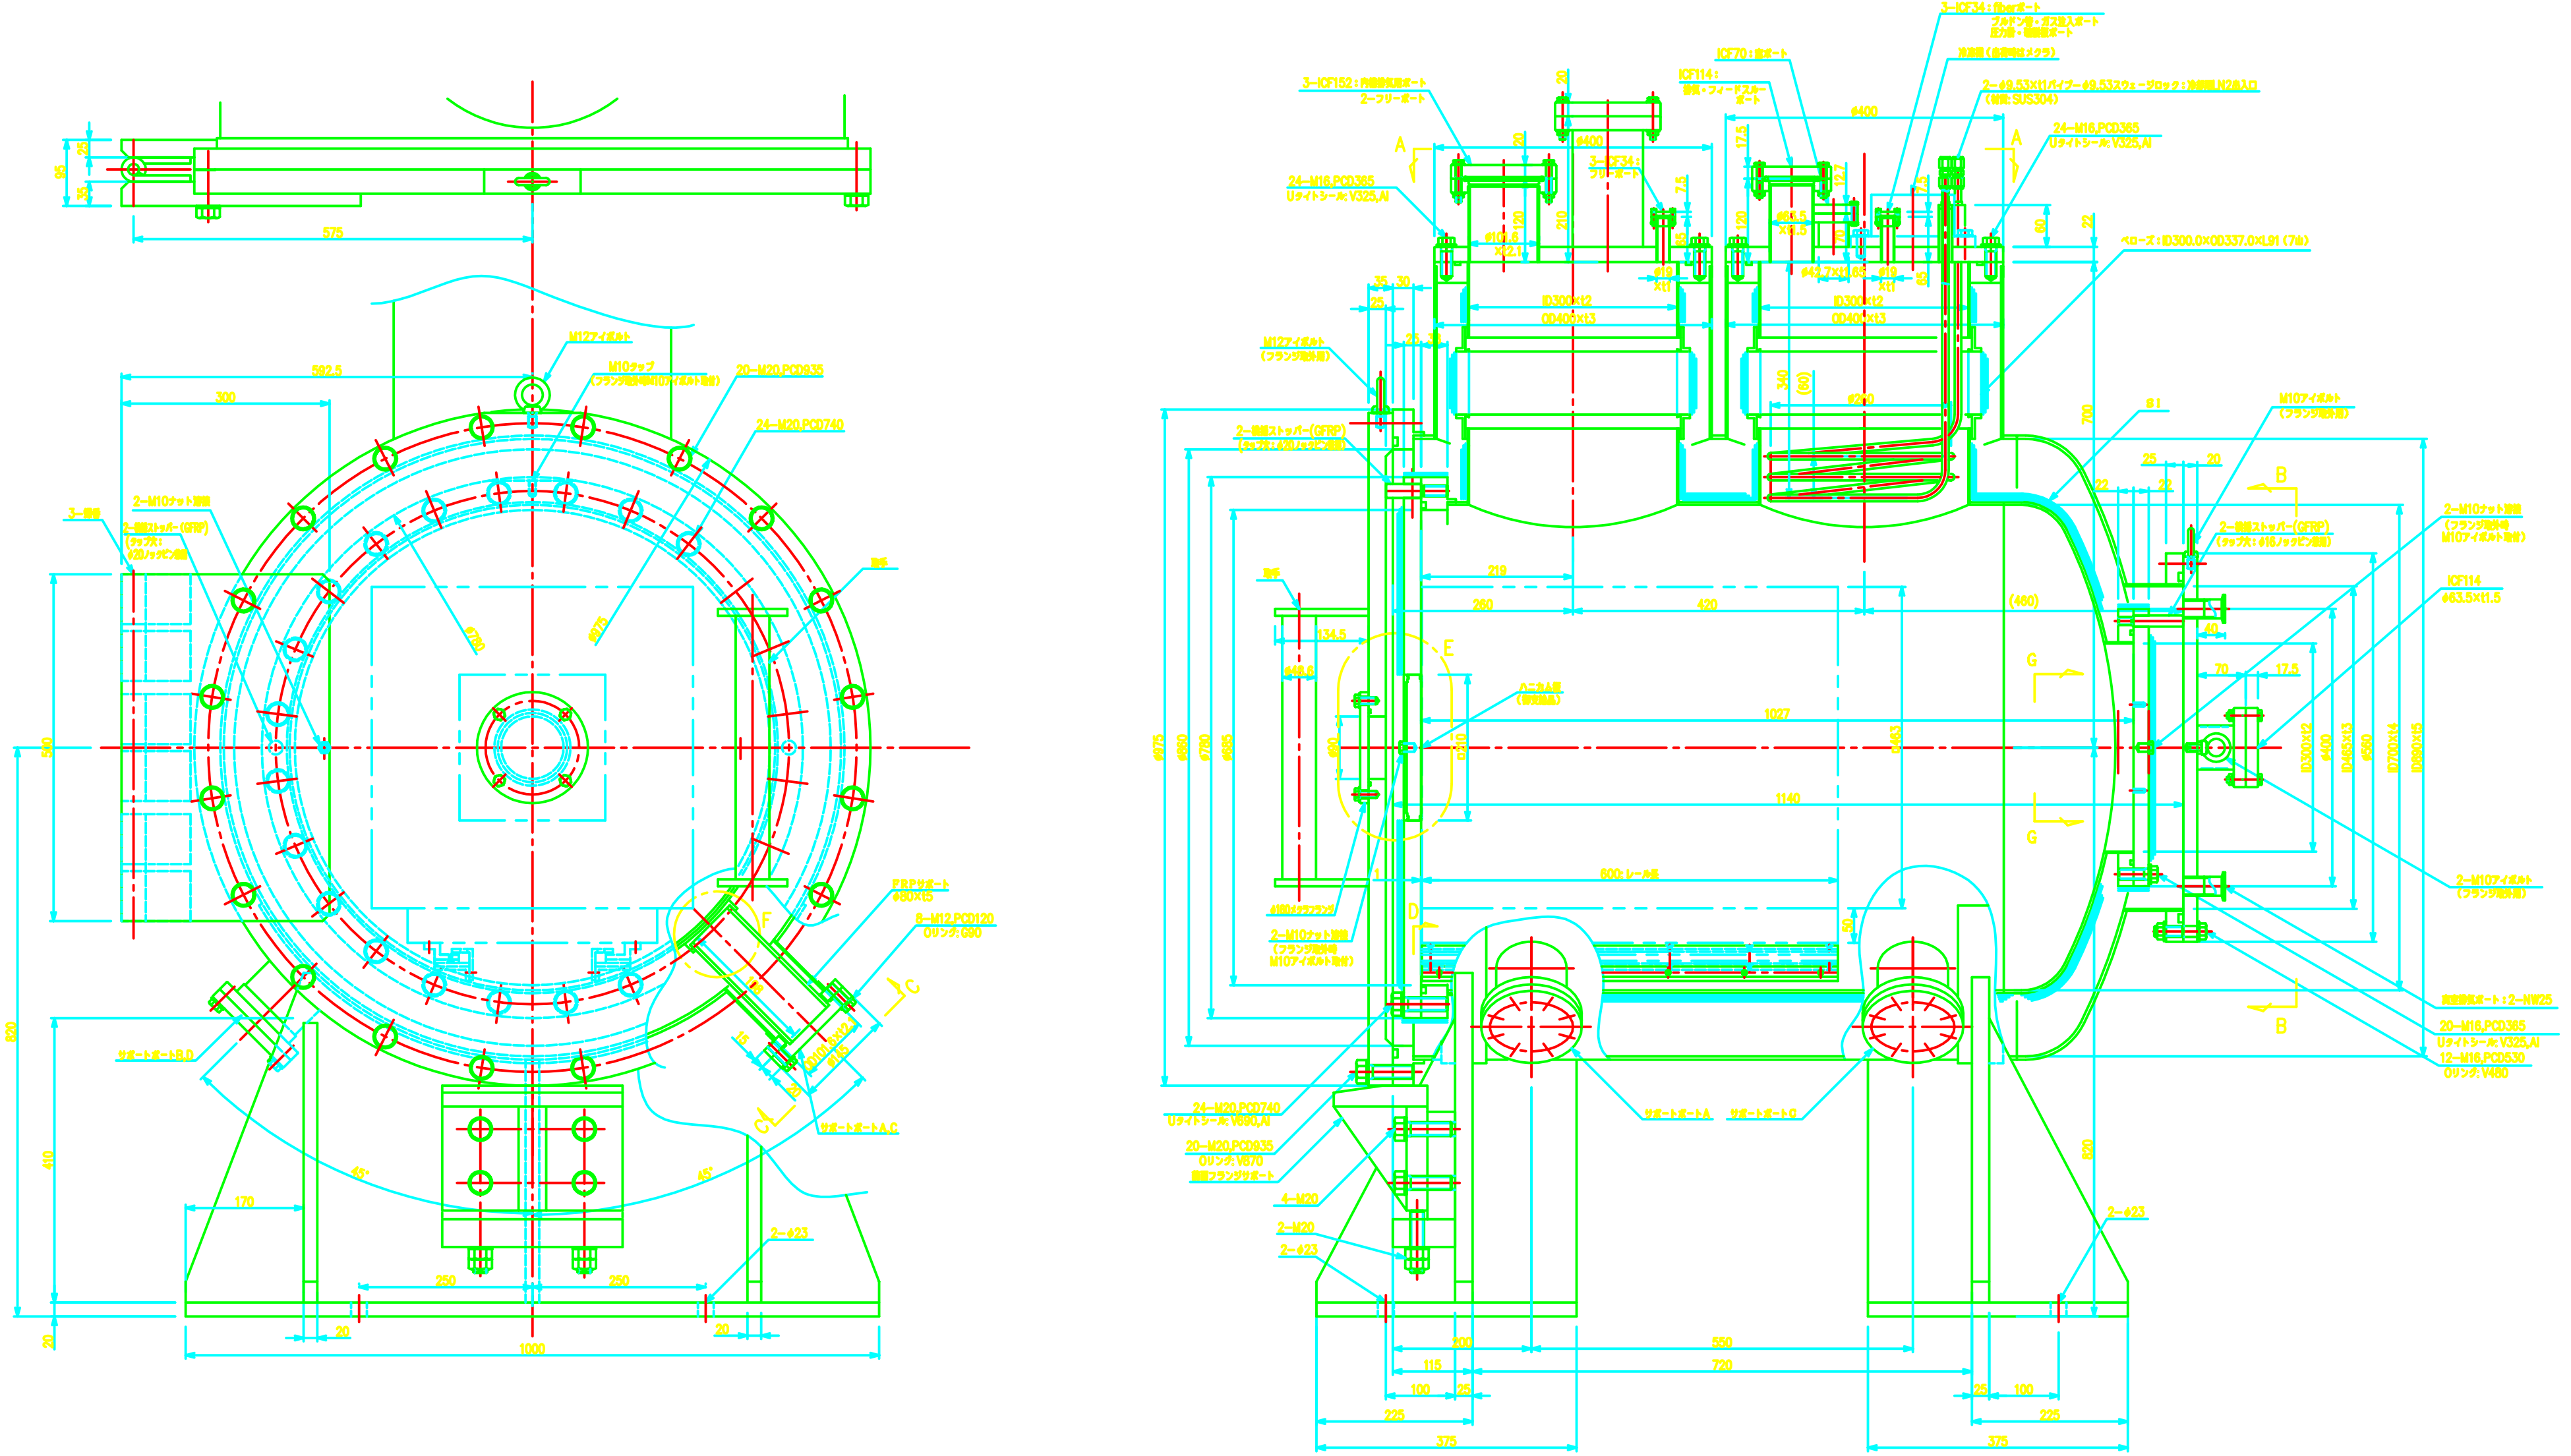

＜ 注 記 ＞

1．材質：容器　支持なき部分はSUS304
　　内槽内面表面処理：板材(2B)、アルコール又はアセトンにより脱脂
　　脚柱 SUS304
2．質量：約1350kg（計算値 測定器・液体キセノンを除く）
3．仕様：使用圧力 0.2MPa 耐圧力 0.5MPa
　　温度 165~343K
　　内筒耐荷重 900kg（キセノン600kg含）
　　熱負荷 30W以下（165K）
4．製作数：1式

5．付属品：(1)アイボルト（M10×12ヶ,M12×1ヶ）
(2)横振れストッパー（GFRP） φ400フランジ用 2ヶ
　　φ780フランジ用 2ヶ
(3)ノックピン（SUS304） φ400フランジ用 2ヶ
　　φ560フランジ用 2ヶ
　　φ780フランジ用 2ヶ
(4)輸送治具 1式

| Rev No | 訂正事項 Revision note | 年月日DATE | 訂正REV'D | 承認APP'D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 完成 | 010213 | A.T | S.Goto |
| 3 | 冷凍機取付部分変更,GFRPｻﾎﾟｰﾄ形状,脚柱変更等 | 001019 | A.T | S.Goto |
| 2 | 9/28お打合せ内容織込 | 001004 | A.T | S.Goto |
| 1 | ポート追加 | 000923 | A.T | S.Goto |

| ITEM 品番 | 名称 TITLE | 材質 MATERIAL | QTY 数量 | 図番 DWG.No. | 備考 DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 TITLE |
|---|---|---|---|---|
| | S.Goto 000916 | | A.T 000915 | 液体キセノンカロリーメータ 試験用容器・組立図（1） |
| 三角法 3rd Angle | 尺度 SCALE 1/5 | 単位 UNIT mm | SIZE A1 | 工事番号 WORK No. 122-00077 |

株式会社ジェック東理社

図面番号 DRAWING No. 1-00077-Q010　Rev. 4